

*И/к - 16.10.2019 - 1*

["ООО \"УроГин Солюшнз\""]  
<urogyn.sol@gmail.com>

Втр, 15-10-2019 19:47

---

От: ["ООО \"УроГин Солюшнз\""] <urogyn.sol@gmail.com>

Кому: [to86@fas.gov.ru]

Копия: [Logistika.ugrakor@yandex.ru]


Тема: Жалоба

Attachments: [ЖАЛОБА 31908375106.docx 37.8 KB] [выписка в отношении заявителя.pdf 229.7 KB]  
[Приложение №1.pdf 526 KB]

Добрый день!  
Просим принять жалобу к рассмотрению.

--

С уважением,  
ООО «УроГин Солюшнз»

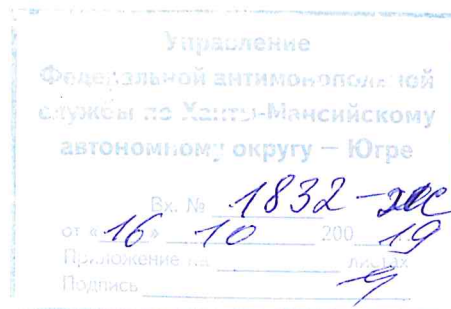



**УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**

Юридический, фактический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.27

Почтовый адрес: 628002, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.27

Официальный сайт: [www.hmao.fas.gov.ru](http://www.hmao.fas.gov.ru)

E-mail: [to86@fas.gov.ru](mailto:to86@fas.gov.ru)

Телефон/факс: (3467) 388 – 081

**ЖАЛОБА**

**на действия Заказчика**

**Извещение № 31908375106**

**Наименование заказчика, контактная информация:** АУТНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АУТНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ЮГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА"

Место нахождения и Почтовый адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д.31

Адрес электронной почты:

[Logistika.ugrakor@yandex.ru](mailto:Logistika.ugrakor@yandex.ru)

Номер контактного телефона/факса: 8 (3467) 36-19-06

Контактное лицо: Силкин А.С.

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «УроГин Солюшнз»

ОГРН: 1127746222889, ИНН: 7733797397,  
КПП: 501701001

Место нахождения и Почтовый адрес:

143500, Московская область, г. Истра, Чеховский переулок, дом 5, ком.№6А.

Тел./факс: 8(499)551-66-25

Адрес эл. почты: [UROGYN.SOL@gmail.com](mailto:UROGYN.SOL@gmail.com)

«15» октября 2019г.

**По мнению Заявителя, нарушение его прав и законных интересов со стороны Заказчика выразилось в установлении в документации запроса котировок в электронной форме требований, влекущих ограничение конкуренции.**

Извещением № 31908375106 на сайте <http://zakupki.gov.ru> размещена закупка путем проведения запроса котировок в электронной форме

Наименование закупки: Поставка аппарата для электромагнитной экстракорпоральной ударно-волновой терапии 91п

Дата начала срока подачи заявок: 07.10.2019 (МСК+2)

Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2019 в 17:00 (МСК+2)

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://etp.gpb.ru/>

Изучив положения документации, было обнаружено, что действующая редакция технического задания по совокупности технических характеристик соответствует исключительно аппарату ударно-волновой терапии Dornier Aries с принадлежностями, производителя Dornier MedTech Europe GmbH.

Параметр Аппарата для электромагнитной экстракорпоральной ударно-волновой терапии, указанный в **п. 2.1 Технического задания**: точная фокусировка ударных волн с помощью неизнашиваемой акустической линзы – наличие, ограничивает конкуренцию, поскольку данному параметру соответствует исключительно Аппарат для ударно-волновой терапии Dornier Aries с принадлежностями, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09554 от 18.04.2011.

Существуют возможности получать Фокусированную ударную волну также и другими методами, а не только с помощью неизнашиваемой акустической линзы. Кроме того, в медицинской практике нет достоверных аргументов в пользу неизнашиваемой акустической линзы.

Параметр Аппарата для электромагнитной экстракорпоральной ударно-волновой терапии, указанный в **п. 2.3 Технического задания**: адаптация глубины проникновения волны от поверхностного уровня до глубокого применения без необходимости применять сменные аппликаторы или насадки – наличие, ограничивает конкуренцию, поскольку данному параметру соответствует исключительно Аппарат для ударно-волновой терапии Dornier Aries с принадлежностями, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09554 от 18.04.2011.

Исключение данного параметра из технического задания позволило бы принять участие в закупке также и поставщикам иного оборудования.

Кроме того, данная функция достигается путем изменения частоты, что не доказывает ее эффективность.

Параметр Аппарата для электромагнитной экстракорпоральной ударно-волновой терапии, указанный в **п. 2.4 Технического задания**: возможность определять размеры фокуса или глубину проникновения без необходимости применять сменные аппликаторы или насадки – наличие, ограничивает конкуренцию, поскольку данному параметру соответствует исключительно Аппарат для ударно-волновой терапии Dornier Aries с принадлежностями, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09554 от 18.04.2011.

Исключение данного параметра из технического задания позволило бы принять участие в закупке также и поставщикам иного оборудования.

Кроме того, данная функция достигается путем изменения частоты, что не доказывает ее эффективность.

Параметр Аппарата для электромагнитной экстракорпоральной ударно-волновой терапии, указанный в **п. 2.5 Технического задания**: запуск различных ударных волн в зависимости от характера применения, выбор единой или адаптируемых частот в диапазоне от 0,5 до 20 Гц, в зависимости от уровня энергии – наличие, также ограничивает конкуренцию, поскольку данному параметру соответствует исключительно Аппарат для ударно-волновой терапии Dornier Aries с принадлежностями, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09554 от 18.04.2011.

Данный диапазон значений эффективен только для данного аппарата, т.к. при помощи изменения частоты, изменяется глубина проникновения.

Изменение данного параметра на «запуск ударных волн в диапазоне частот не менее, Значение: 1 - 8 Гц» позволило бы принять участие в закупке также и поставщикам иного оборудования.

Параметр Аппарата для электромагнитной экстракорпоральной ударно-волновой терапии, указанный в **п. 3.3 Технического задания**: диаметр излучателя, мм - не менее 40, ограничивает конкуренцию, поскольку данному параметру соответствует исключительно Аппарат для ударно-волновой терапии Dornier Aries с принадлежностями, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09554 от 18.04.2011.

Изменение данного параметра на «диаметр излучателя, мм - не менее 30» позволило бы принять участие в закупке также и поставщикам иного оборудования.

Параметр Аппарата для электромагнитной экстракорпоральной ударно-волновой терапии, указанный в **п. 3.7 Технического задания**: плотность потока энергии (ED), мДж/мм<sup>2</sup> - От 0,01 до 0,3, также ограничивает конкуренцию, поскольку данному параметру соответствует исключительно Аппарат для ударно-волновой терапии Dornier Aries с принадлежностями, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09554 от 18.04.2011.

Изменение данного параметра на «плотность потока энергии (ED), мДж/мм<sup>2</sup> – от 0,01-0,55» позволило бы принять участие в закупке также и поставщикам иного оборудования.

Параметр Аппарата для электромагнитной экстракорпоральной ударно-волновой терапии, указанный в **п. 3.8 Технического задания**: эффективная фокусная энергия, мДж - От 0,28 до 21,6 также ограничивает конкуренцию, поскольку данному параметру соответствует исключительно Аппарат для ударно-волновой терапии Dornier Aries с принадлежностями, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09554 от 18.04.2011.

Стоит отметить, что аппараты различных производителей имеют различную эффективную фокусную энергию. Данный параметр не создает каких-либо преимуществ при эксплуатации.

Исключение данного параметра из технического задания позволило бы принять участие в закупке также и поставщикам иного оборудования.

Параметр Аппарата для электромагнитной экстракорпоральной ударно-волновой терапии, указанный в **п. 3.9 Технического задания**: регулируемое число ударных волн в секунду, Гц - От 0,5 до 20, также ограничивает конкуренцию, поскольку данному параметру соответствует исключительно Аппарат для ударно-волновой терапии Dornier

Aries с принадлежностями, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09554 от 18.04.2011.

Данный диапазон значений эффективен только для данного аппарата, т.к. при помощи изменения частоты, изменяется глубина проникновения.

Изменение данного параметра на «регулируемое число ударных волн в секунду, Гц - от 1 до 8» позволило бы принять участие в закупке также и поставщикам иного оборудования.

Параметр Аппарата для электромагнитной экстракорпоральной ударно-волновой терапии, указанный в **п. 5.3 Технического задания**: интенсивность ударно-волновых импульсов – наличие, также ограничивает конкуренцию, поскольку данному параметру соответствует исключительно Аппарат для ударно-волновой терапии Dornier Aries с принадлежностями, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09554 от 18.04.2011.

Исключение данного параметра из технического задания позволило бы принять участие в закупке также и поставщикам иного оборудования.

Кроме того, данный показатель не имеет существенного значения, в том числе, и при эксплуатации оборудования, поскольку в документации присутствуют следующие параметры: суммарная энергия (п. 5.4 Технического задания), частота импульсов (п. 5.2 Технического задания) и общее число ударно-волновых импульсов (п. 5.5 Технического задания).

Параметр Аппарата для электромагнитной экстракорпоральной ударно-волновой терапии, указанный в **п. 6.1 Технического задания**: основной блок (ШхГхВ), мм - Не менее 400х500х200 не более 430х560х240, ограничивает конкуренцию, поскольку данному параметру соответствует исключительно Аппарат для ударно-волновой терапии Dornier Aries с принадлежностями, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09554 от 18.04.2011.

Исключение данного параметра или его изменения на «основной блок (ШхГхВ), мм - Не менее 400х450х180 не более 460х560х240» позволило бы принять участие в закупке также и поставщикам иного оборудования.

Кроме того, данный параметр определяет габариты аппарата, что не имеет существенного значения для эксплуатации аппарата.

Параметр Аппарата для электромагнитной экстракорпоральной ударно-волновой терапии, указанный в **п. 6.2 Технического задания**: масса, кг - не более 21, ограничивает конкуренцию, поскольку данному параметру соответствует исключительно Аппарат для ударно-волновой терапии Dornier Aries с принадлежностями, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09554 от 18.04.2011.

Исключение данного параметра или его изменения на «масса, кг - не более 30» позволило бы принять участие в закупке также и поставщикам иного оборудования.

Указание данных параметров в формулировке Технического задания создает преимущества для производителя Dornier MedTech Europe GmbH, что является неправомерным и нарушает права поставщиков оборудования других производителей, желающих принять участие в закупке.

Документация о закупке и техническое задание сформированы в соответствии с техническими характеристиками товара единственного производителя, что приводит к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Пунктом 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) установлено, что при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в частности, следующим принципом: равноправие, справедливость, **отсутствие дискриминации и**

**необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.**

Из указанного следует, что Закон о закупках, не ограничивая заказчиков в их правах по выявлению поставщиков товаров, работ, услуг, отвечающих требованиям заказчиков путем проведения закупки избранным способом, предусматривает в качестве **одного из принципов, которым заказчик обязан руководствоваться, отсутствие ограничения конкуренции при проведении закупки.**

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется, в частности, в следующем случае: осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Закона о закупках и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика.

Ссылка на описание Аппарата для ударно-волновой терапии Dornier Aries с принадлежностями, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09554 от 18.04.2011: <https://www.rusmedimport.com/physiotherapy/shockwave-therapy/dornier-aries/>  
Пункты, указывающие на единственного производителя, выделены в приложении №1

На основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

**ПРОСИТ:**

- 1) рассмотреть вопрос о соответствии документации запроса котировок в электронной форме действующему законодательству;
- 2) провести на основании информации, содержащейся в настоящей жалобе, внеплановую проверку соблюдения Заказчиком, положений Федерального закона 18.07.2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- 3) по итогам проверки выдать предписание Заказчику об устранении допущенных нарушений Федерального закона 18.07.2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Приложения:**

1. Описание Аппарата для ударно-волновой терапии Dornier Aries с принадлежностями, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09554 от 18.04.2011
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении Заявителя

Генеральный директор

ООО «УроГин Солюшз»

Горбатов К.В.